МИНИСТЕРСТВО
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
ЛЬВОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

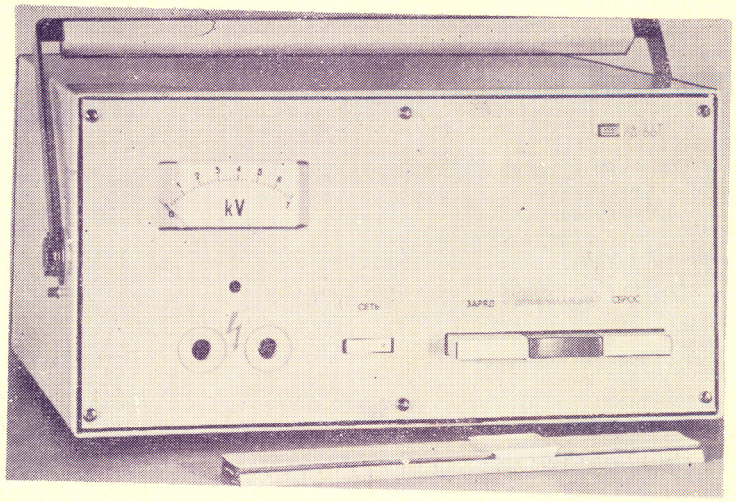

ДЕФИБРИЛЛЯТОР ИМПУЛЬСНЫЙ

ИД-66

Дефибриллятор импульсный ИД—66 предназначен для электроимпульсного лечения острых и хронических нарушений сердечного ритма.

Аппарат может быть использован для прекращения атонических послеродовых маточных кровотечений в акушерской практике.

Аппарат генерирует одиночные импульсы продолжительностью 6—8 мсек, получаемые путем разряда конденсатора на объект через катушку индуктивности.

Заряд конденсатора осуществляется от высоковольтного выпрямителя. Напряжение на конденсаторе контролируется киловольтметром.

Электрическая схема аппарата изолирована от корпуса.

К аппарату прилагается комплекс электродов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Питание от сети переменного тока:	
напряжение, *в*	127 или 220
частота, *гц*	50
Время заряда конденсатора до напряжения 7 *кв, сек*	не более 15
Продолжительность одной полуволны импульса, *мсек*	6—8
Мощность, потребляемая аппаратом в момент начала заряда, *ва*	не превышает 600
Габариты, *мм:*	
длина	423
ширина	330
высота	215
Вес аппарата без принадлежностей и упаковки, *кг*	не более 22

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Львовский завод радиоэлектронной медицинской аппаратуры.

Редактор *Б. Л. Татаренко*
Художник *Л. И. Морозов*
Художественный редактор *В. Е. Лучко*
Корректор *Н. Ф. Смирнова*

Львовская редакция издательства «Реклама»
БГ 01090. 1969 г Изд. № 1426. Зак. № 4084. Тираж. 5 000.
Нестеровская городская типография.